

## Bewertungsschreiben

Nummer 20-002954-PR01 (NW-P01-09-de-01)

Inhaber Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  
Referat Produktsicherheit - V22  
Billstr. 80  
20539 Hamburg  
Deutschland

Produkt Partikelfilternde Halbmaske

Bezeichnung Lieferbezeichnung: Respirator Masks KN95

Details Produkthersteller Changshu Hengyun Textile Co., Ltd.;  
Chargennummer 2020040602

Besonderheiten Etwaig auf dem Produkt und/oder Verpackung angebrachte Kennzeichnungen wurden nicht auf ihre Richtigkeit überprüft.

Ergebnis

Bewertung der Konformität von Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutz (CPA) nach dem Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Revision 2 vom 02.06.2020



**Anforderung: erfüllt**

Die technische Wirksamkeit des oben genannten Produkts ist im Rahmen der Verkehrsfähigkeit gemäß § 9 Abs. 2 Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV zu vermuten. CPA mit Ausatemventil(en) eignen sich grundsätzlich nicht für den Fremdschutz.

ift Rosenheim  
22.07.2020

Stv. Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

## Grundlagen

Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Revision 2 vom 02.06.2020

Prüfbericht: 20-002954-PR01 PB-P01-09-de-01

## Verwendungshinweise

Dieses Bewertungsschreiben dient für die Dauer der Feststellung der epidemischen Lage durch die Bundesregierung zur Vorlage bei den Marktaufsichtsbehörden zur Feststellung der Verkehrsfähigkeit. Dieses Schreiben darf nicht dazu genutzt werden um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Die Verkehrsfähigkeit der PSA in der Bundesrepublik Deutschland stellt die zuständige Marktüberwachungsbehörde im Sinne des § 24 Absatz 1 Produktsicherheitsgesetz fest.

Dieses Verfahren ersetzt keine Konformitätsbewertung nach der PSA Verordnung (EU) 2016/425. Die Bestätigung der Erfüllung aller Anforderungen des Prüfgrundsatzes alleine berechtigt auch nicht zur Bereitstellung entsprechender Produkte auf dem Unionsmarkt.

Sie können die für Sie zuständige Marktüberwachungsbehörde über die Website der ZLS suchen. Der Prüfgrundsatz kann ebenfalls über die Website der ZLS eingesehen werden.

## Gültigkeit

Dieses Bewertungsschreiben dient für die Dauer der Feststellung der epidemischen Lage durch die Bundesregierung zur Vorlage bei den Marktaufsichtsbehörden zur Feststellung der Verkehrsfähigkeit.

Die Bewertung basiert auf der Prüfung von Stichproben (lt. o.g. Prüfbericht) und gilt ausschließlich für das beschriebene Produkt.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das Merkblatt zur Benutzung von ift-Produktionen.

## Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: QBC-9164F

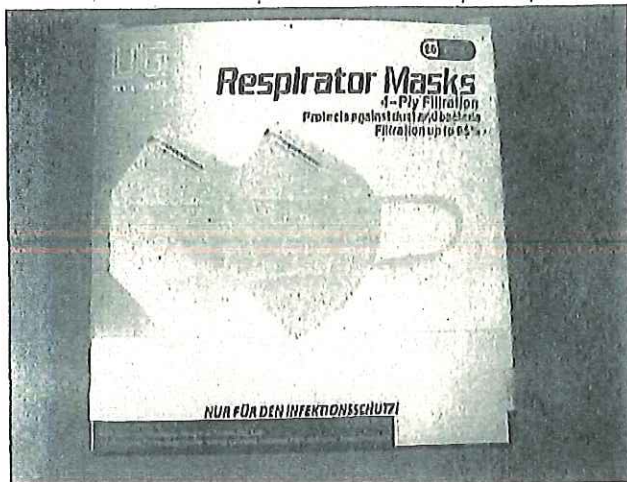


Bild 1 Verpackung der Probekörper

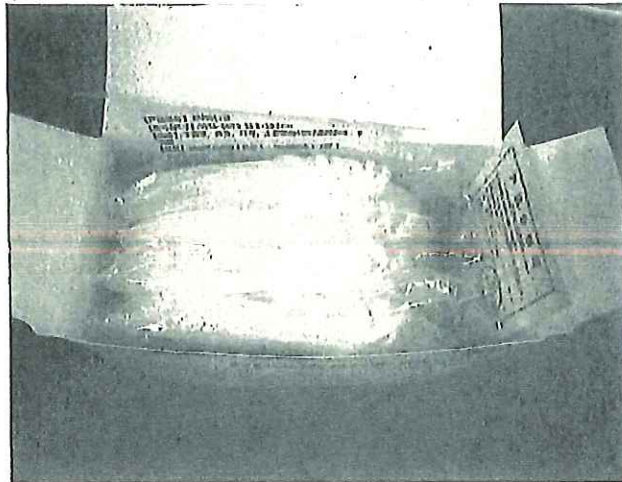


Bild 2 Verpackung der Probekörper

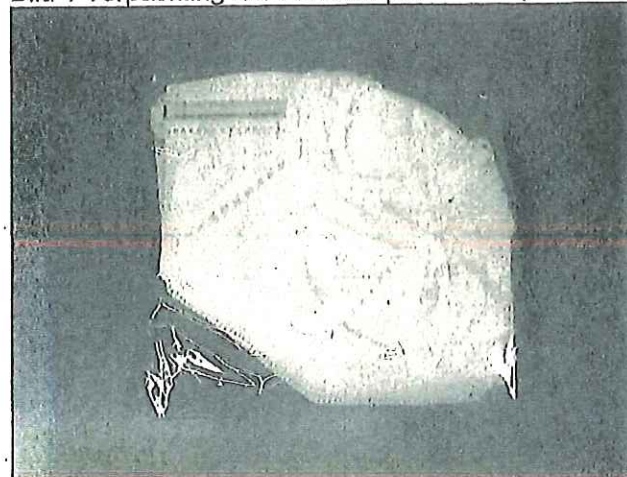


Bild 3 Einzelverpackung

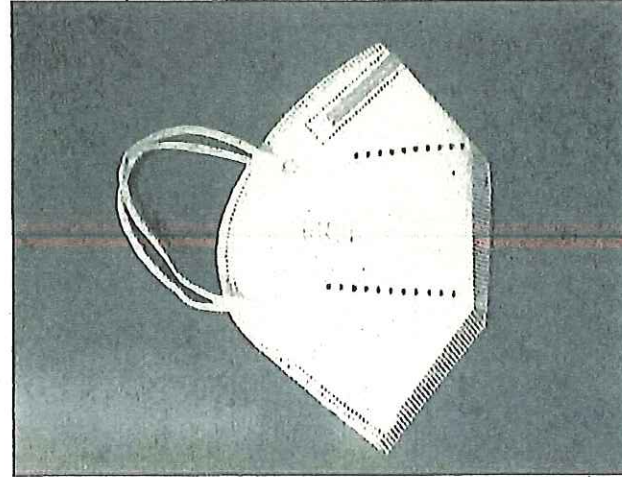


Bild 4 Ansicht des Probekörpers

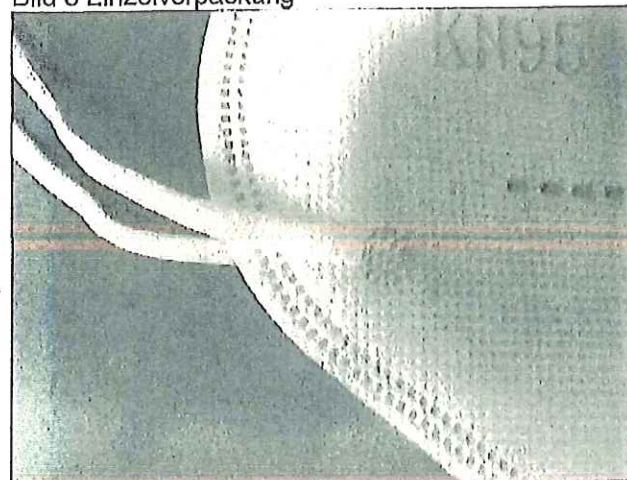


Bild 5 Anbindung der Kopfbänderung



Bild 6 Detail Nasenbügel